Poison center Munich (24/7):
+49 (0) 89-19240 (German and English)

Silicate
Silicate
Силікат
Silikat
Silicato

0.00 - 5.00 мг/л SiO_2

Silicate No. 1
Silicate No. 2
Silicate No. 3

1

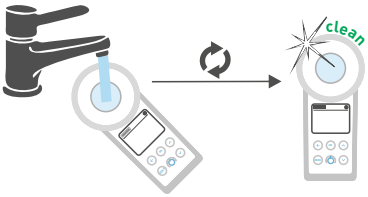

2

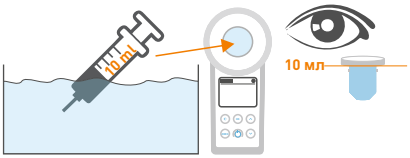

After / Après / Після / Nach / Dopo ZERO

3

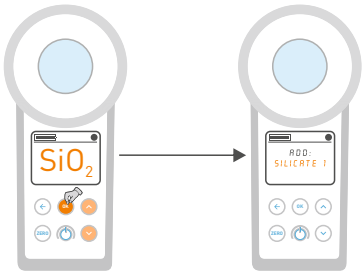

4

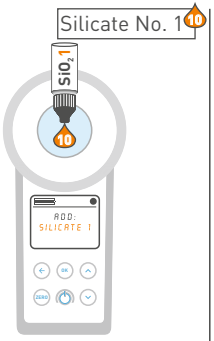

5

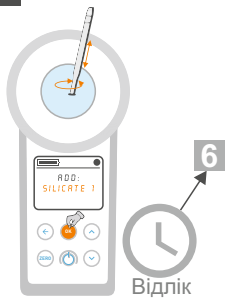

6

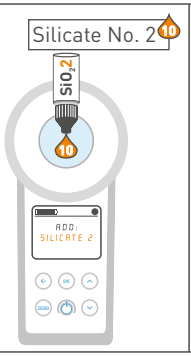

7

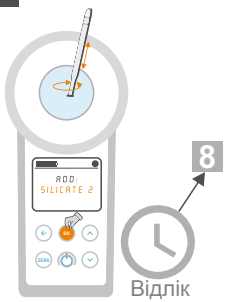

8

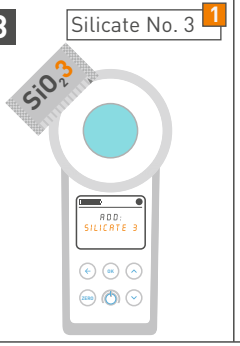

9



10

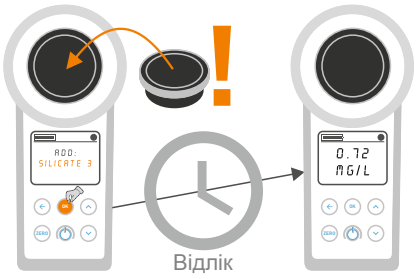

Notes

- The reaction is designed for a sample temperature of 20 ° C. Lower temperatures can lead to lower results.
- La réaction est conçue pour une température d'échantillon de 20 °C. Des températures plus basses peuvent conduire à des résultats inférieurs.
- Реакція розрахована на температуру 20°C. Нижчі температури можуть призвести до нижчих результатів.
- Die Reaktion ist auf eine Probentemperatur von 20°C ausgelegt. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu Minderbefunden kommen.
- La reazione è progettata per una temperatura del campione di 20° C. Temperature più basse possono portare a risultati inferiori.

Примітки